


TruSeq Custom Amplicon Kit Dx[®]

Workflow- und Kit-Kontrollformular FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

Ausführliche Anweisungen finden Sie in der *Packungsbeilage zum TruSeq Custom Amplicon Kit Dx* (Dokument-Nr. 1000000029772).

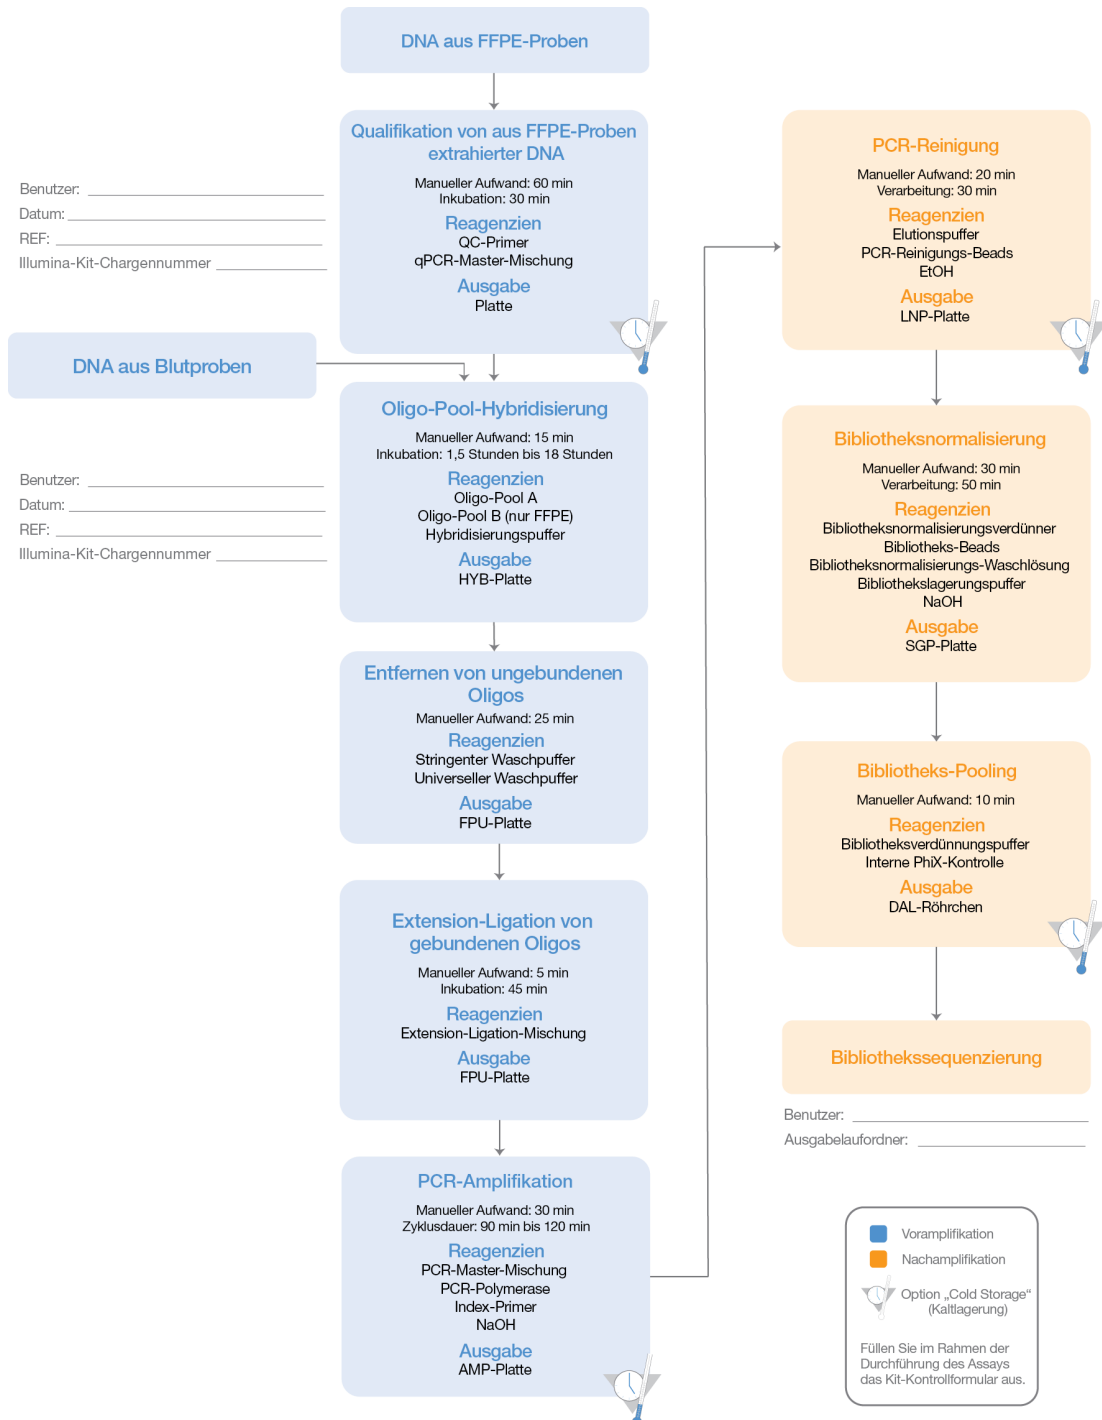

TruSeq Custom Amplicon Kit Dx

Workflow- und Kit-Kontrollformular

[Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.]



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornien 92122, USA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Niederlande



Australische Niederlassung:
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australien