


# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx<sup>®</sup>

## Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit PER USODIAGNOSTICO IN VITRO

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento all'*Insero della confezione di TruSeq Custom Amplicon Kit Dx* (documento n. 1000000029772).

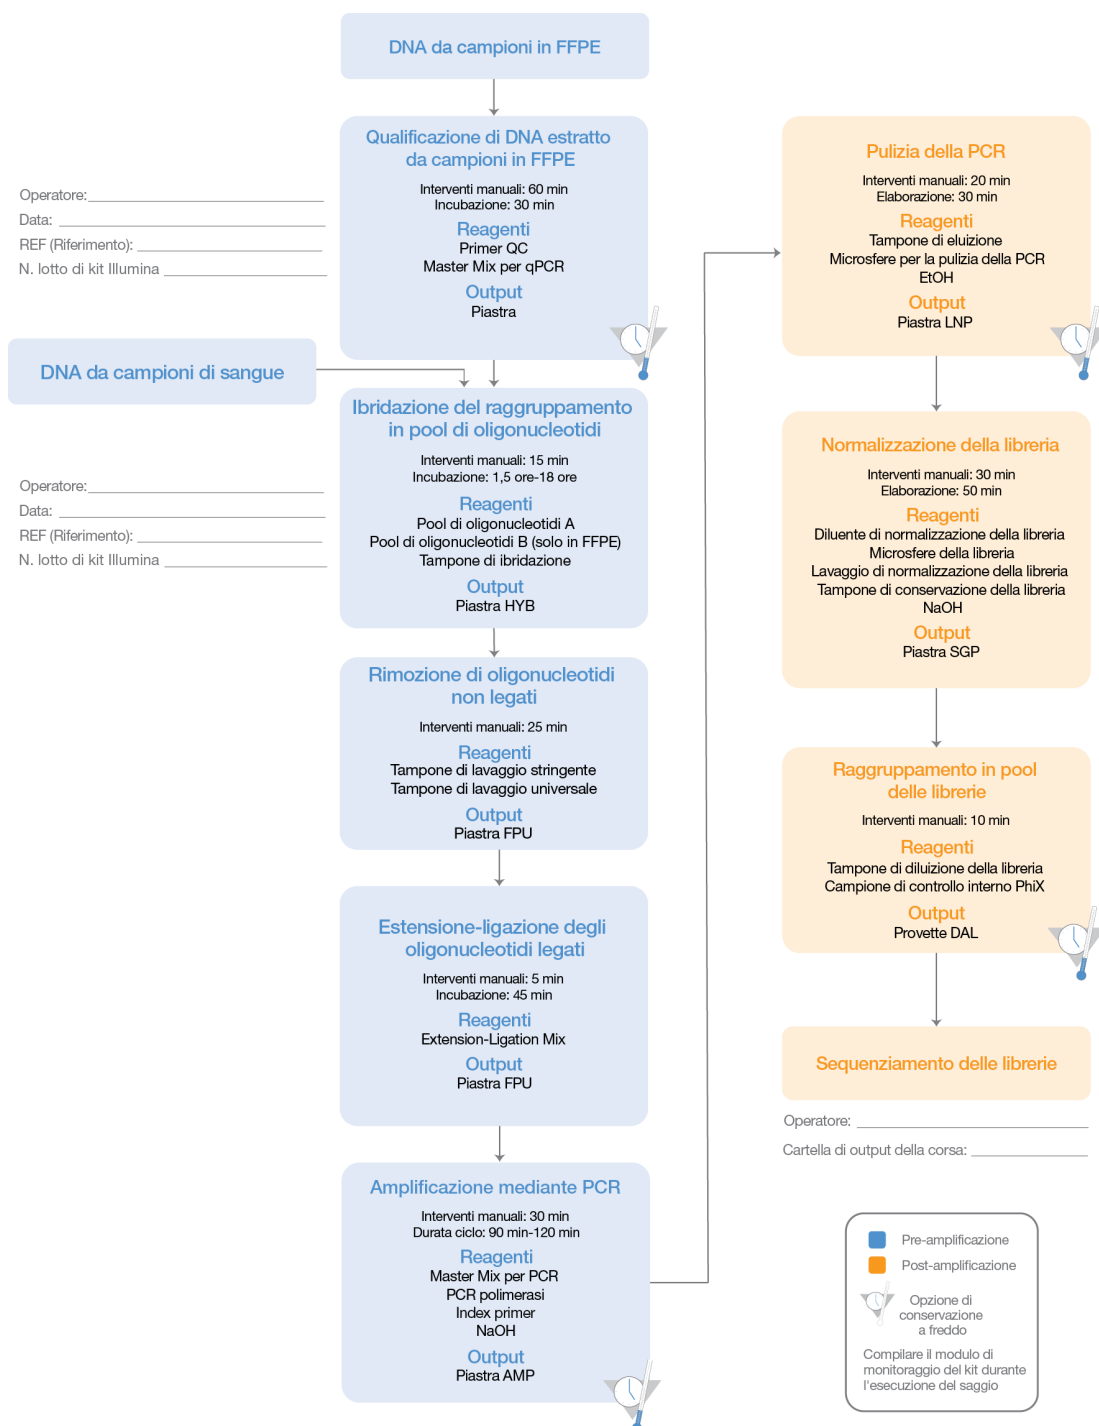

# TruSeq Custom Amplicon Kit Dx


## Flusso di lavoro e modulo di monitoraggio del kit

[Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota]



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 U.S.A.  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (fuori dal Nord America)  
techsupport@illumina.com  
[www.illumina.com](http://www.illumina.com)

Documento n. 1000000039154 v02 ITA  
Pagina 2 di 2



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
Paesi Bassi



Sponsor Australiano:  
Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australia